




UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS
ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO – EEAP
LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO CLÍNICO




APRESENTAÇÃO INDICADORES – MAIO 2021

*Rachel de Oliveira Gomes da Silva – Enfermeira
Responsável Técnica do Laboratório de
Habilidades nos Cuidados em Saúde e
Laboratório de Simulação e Aperfeiçoamento
Clínico*


Número de atividades realizadas no laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

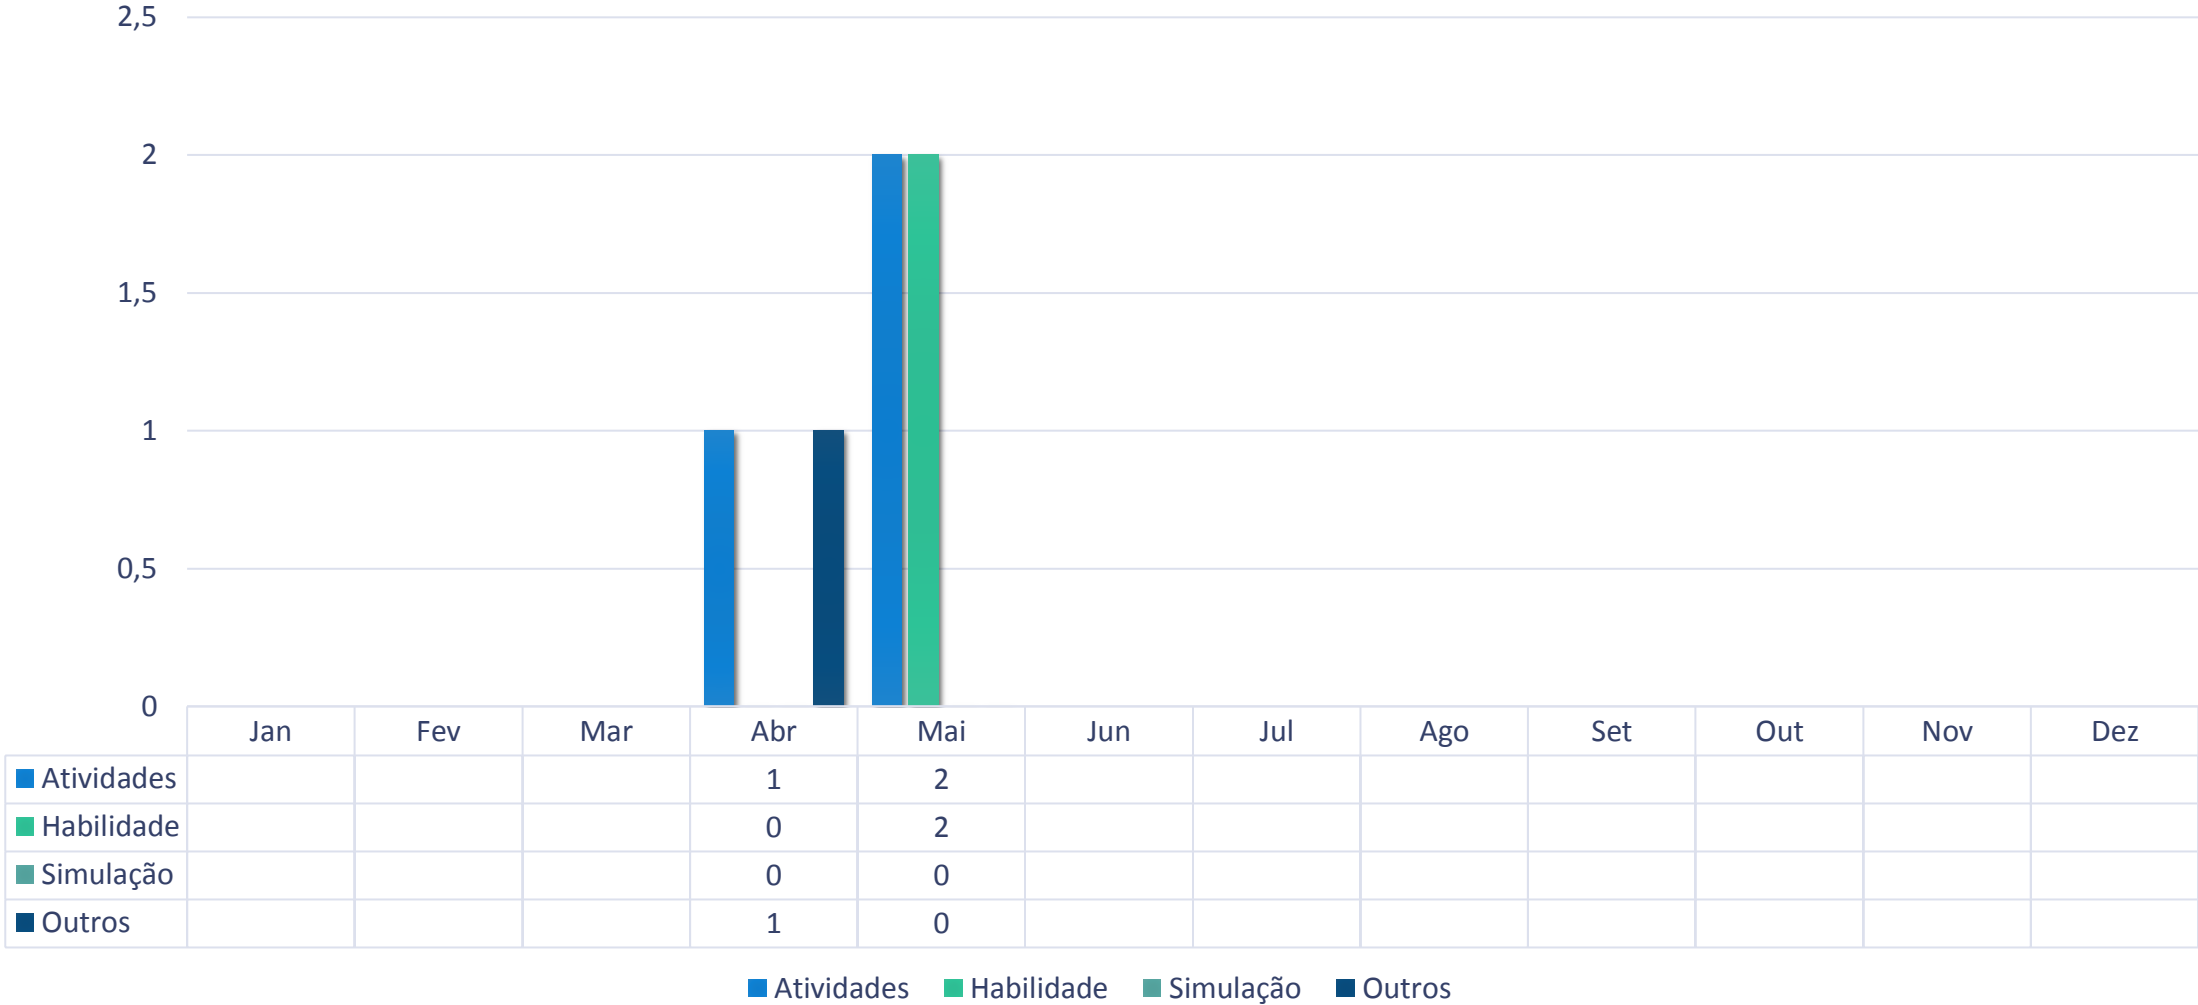

Disciplinas que utilizaram o laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

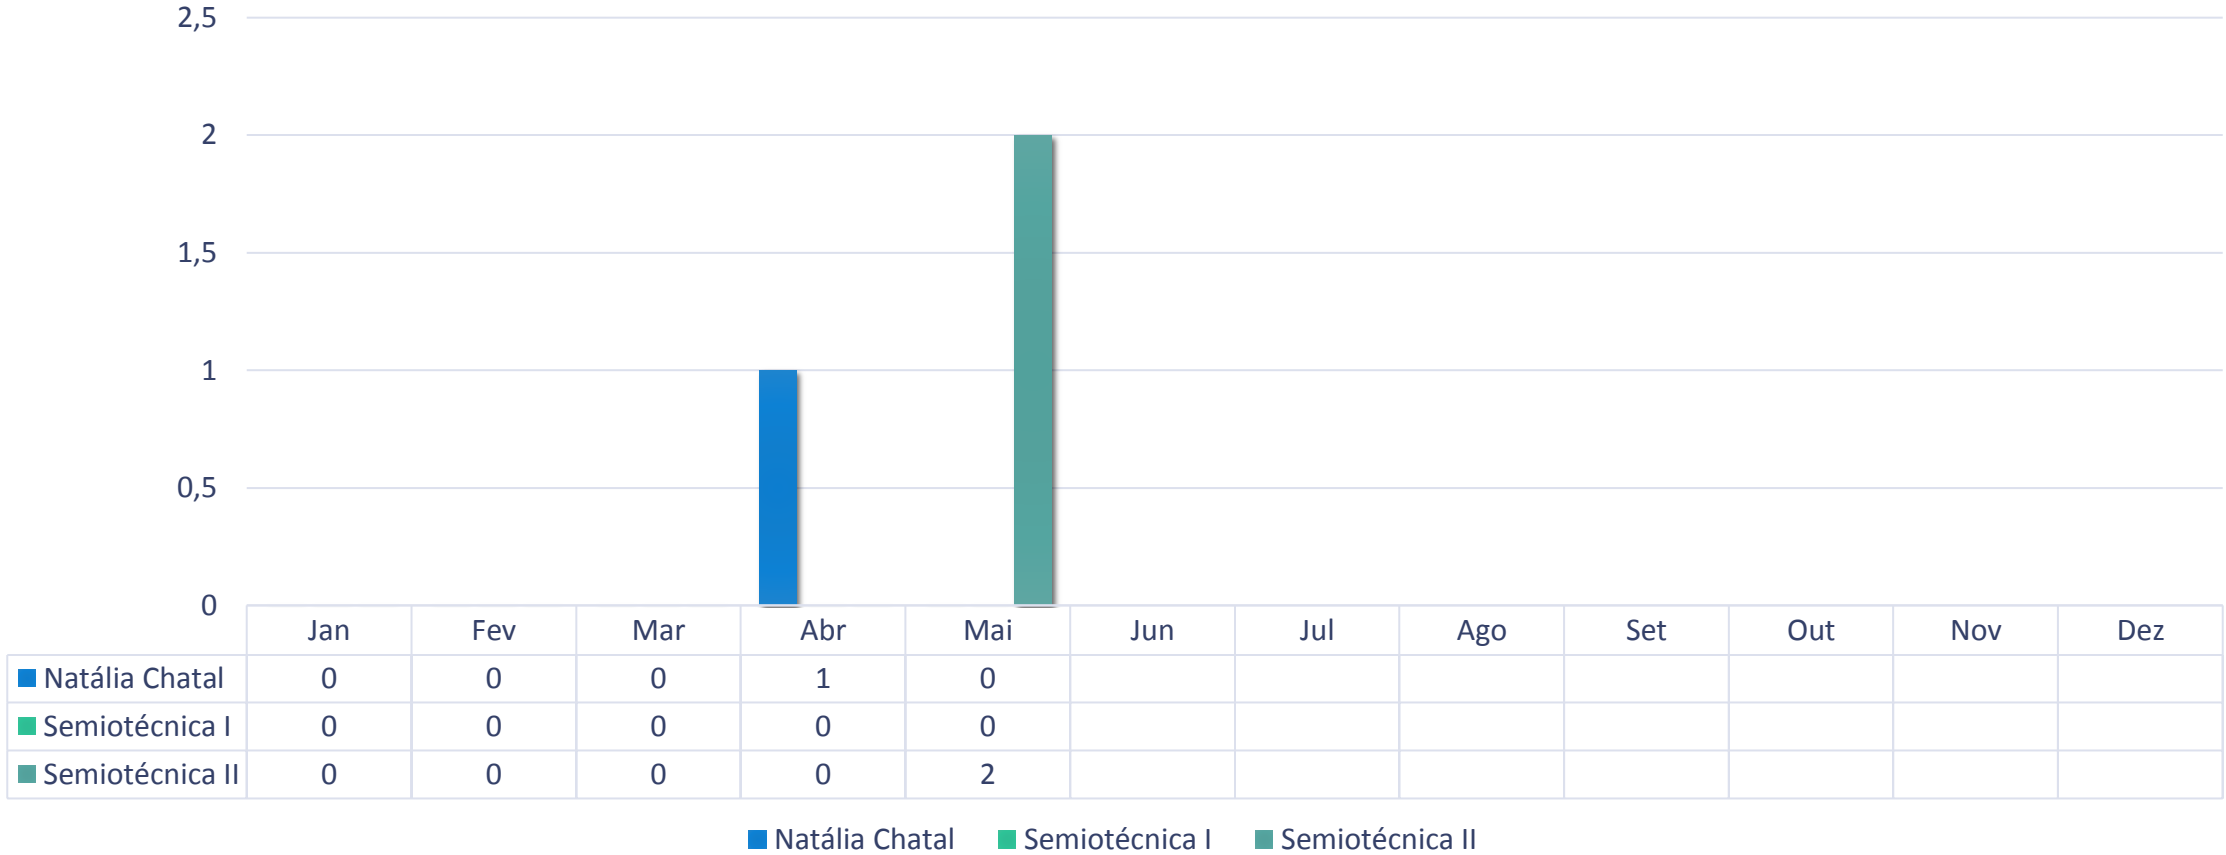


Número de participantes das atividades no laboratório simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

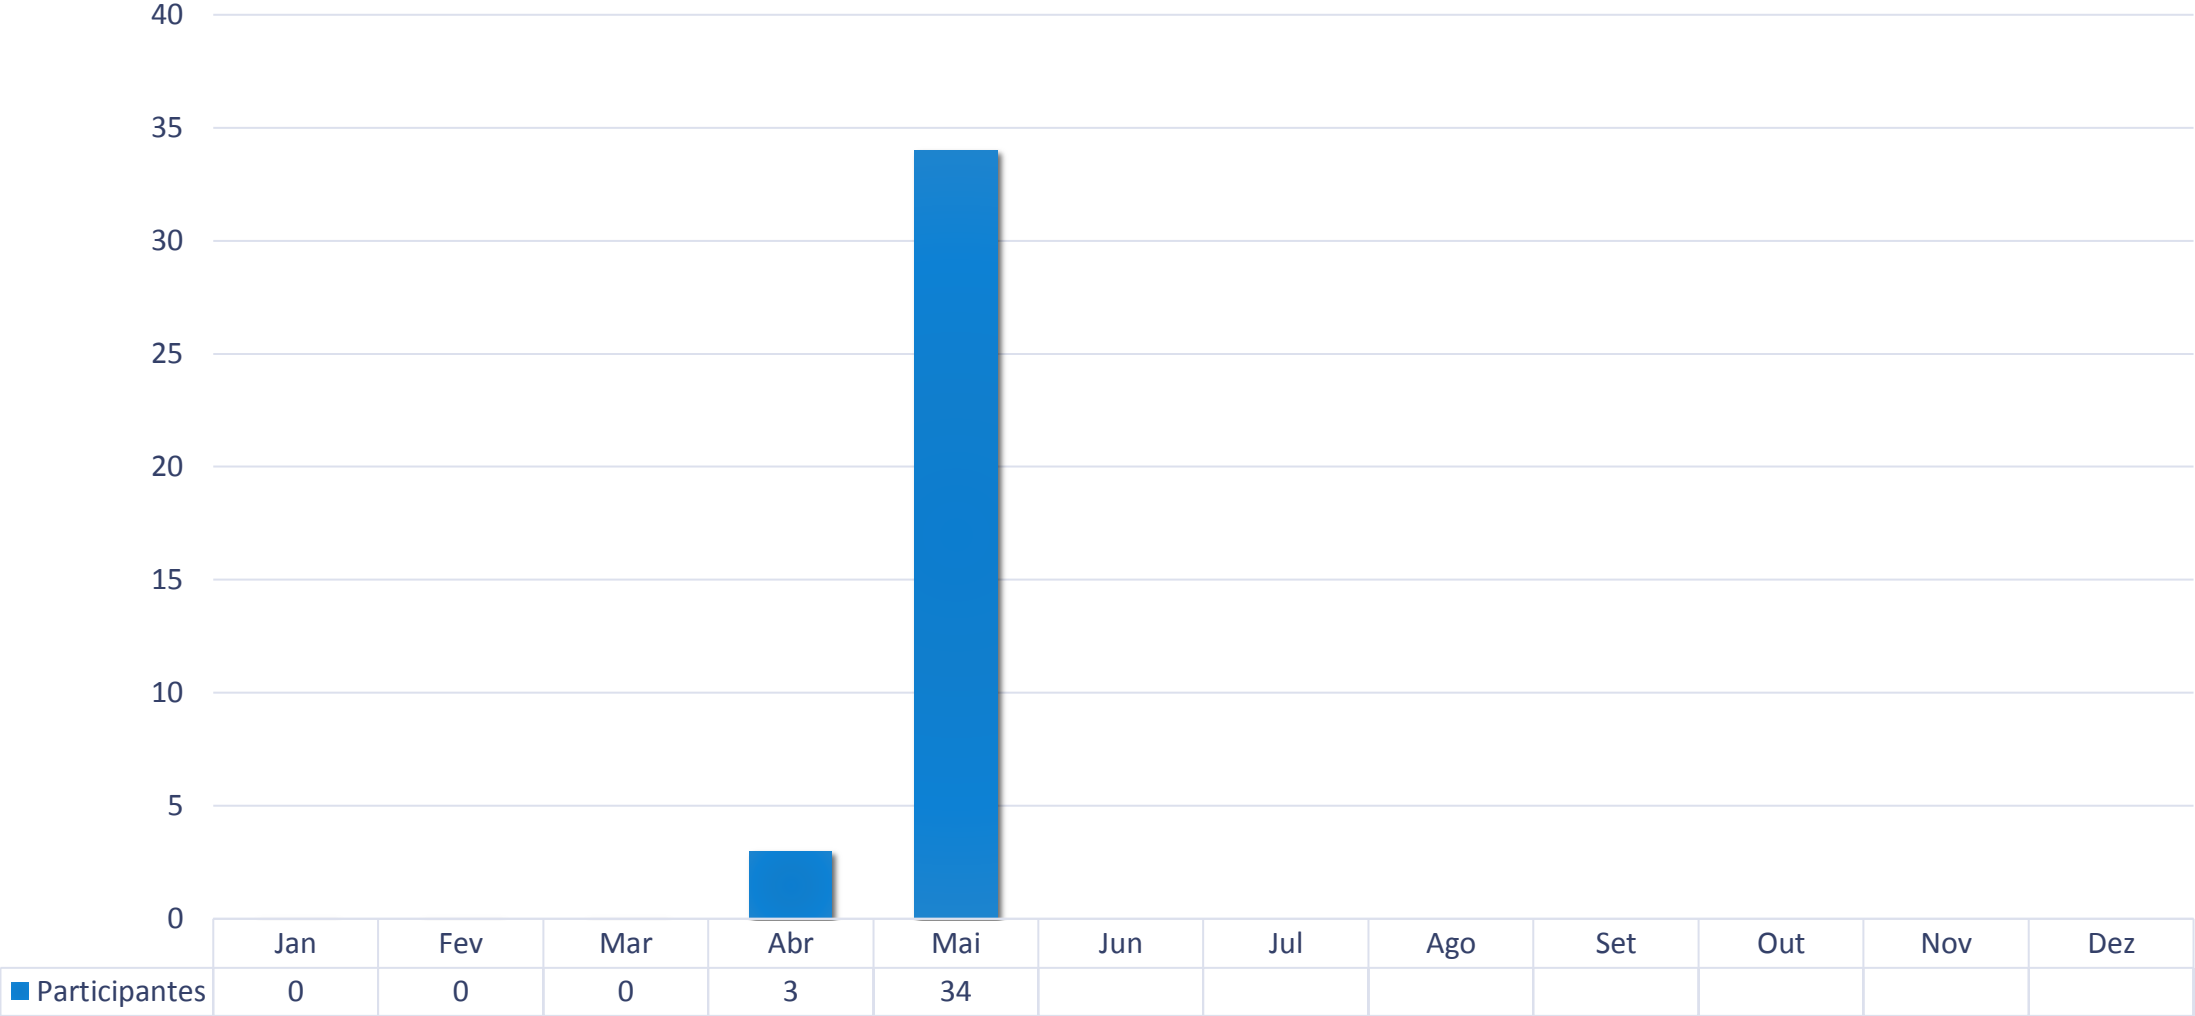


**Formulários
respondidos: 7
Discentes: 6
Docentes: 1**

Percentual de adequação da iluminação no laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

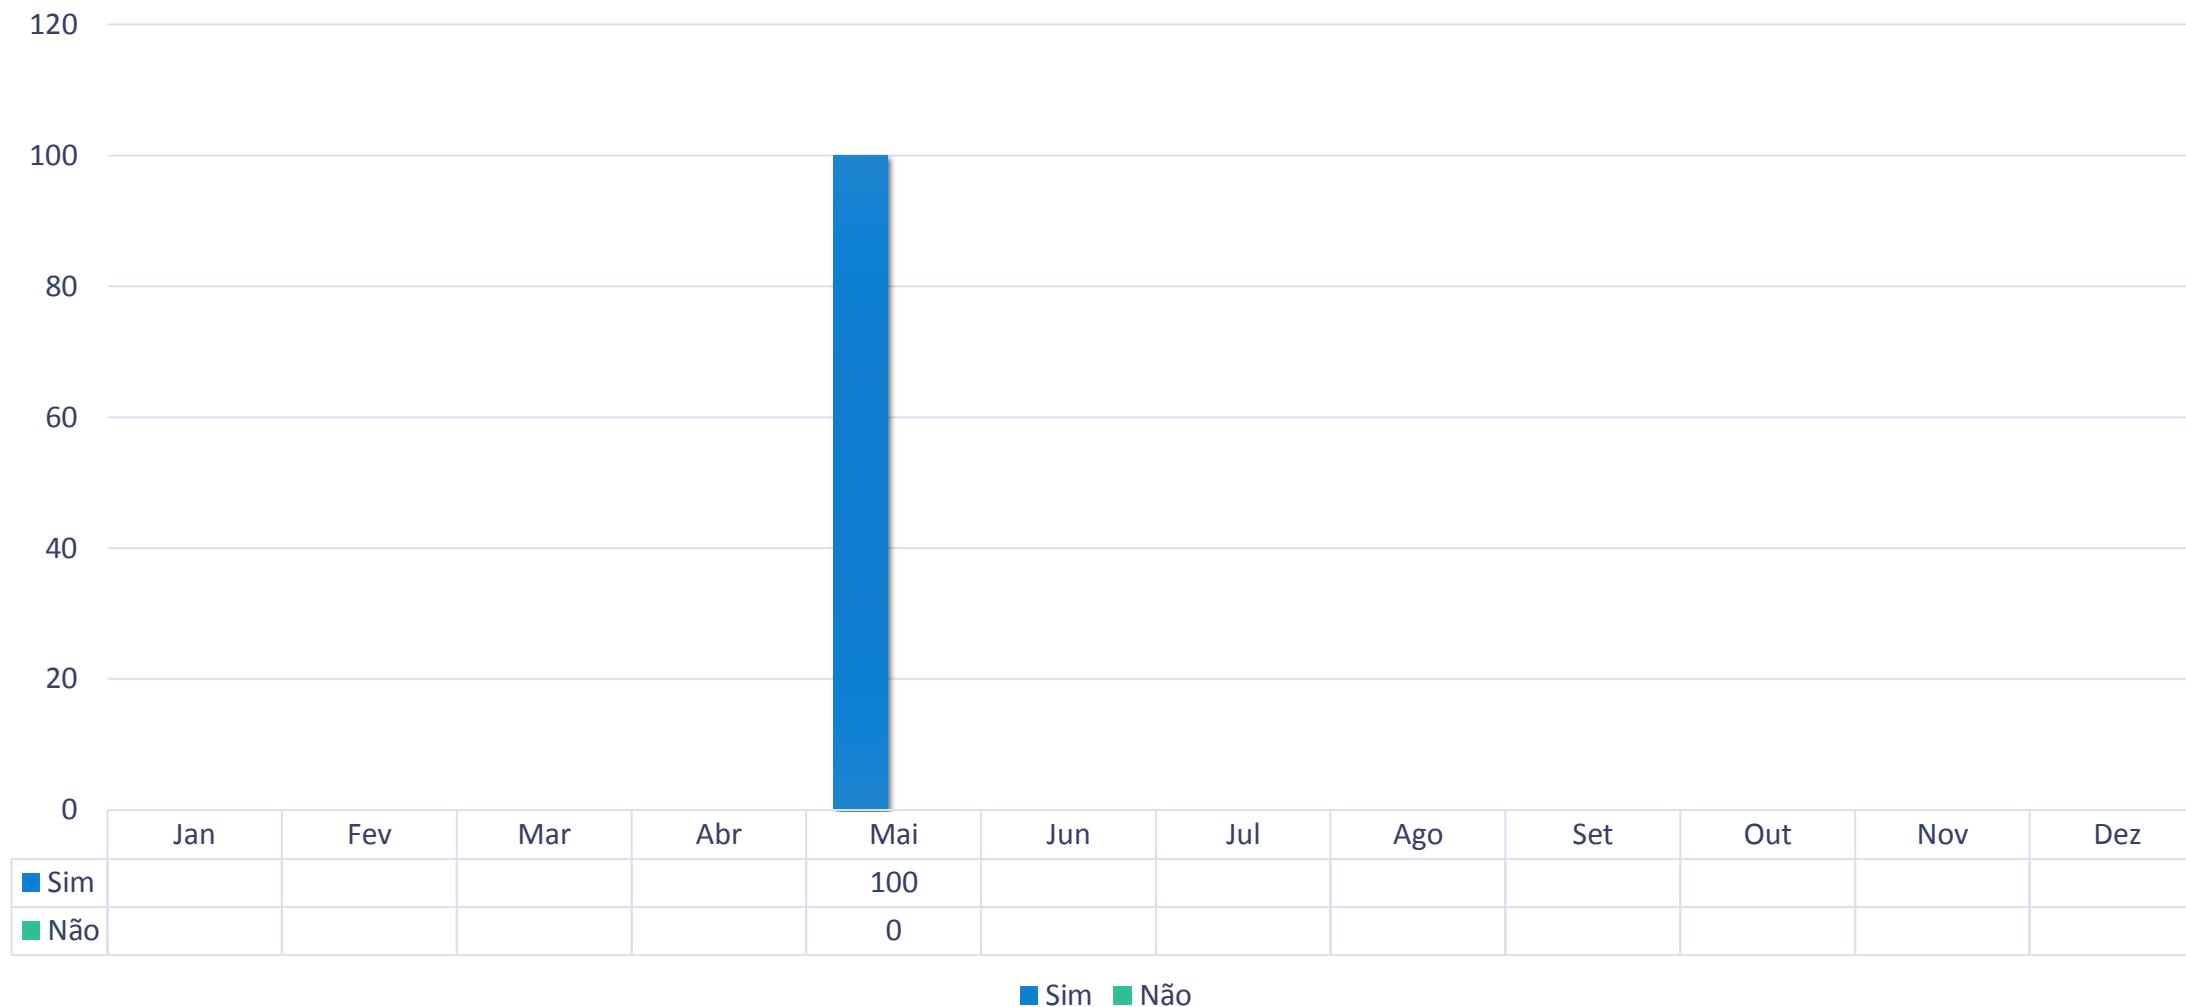

**Formulários
respondidos: 7
Discentes: 6
Docentes: 1**


Percentual de adequação da ventilação no laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

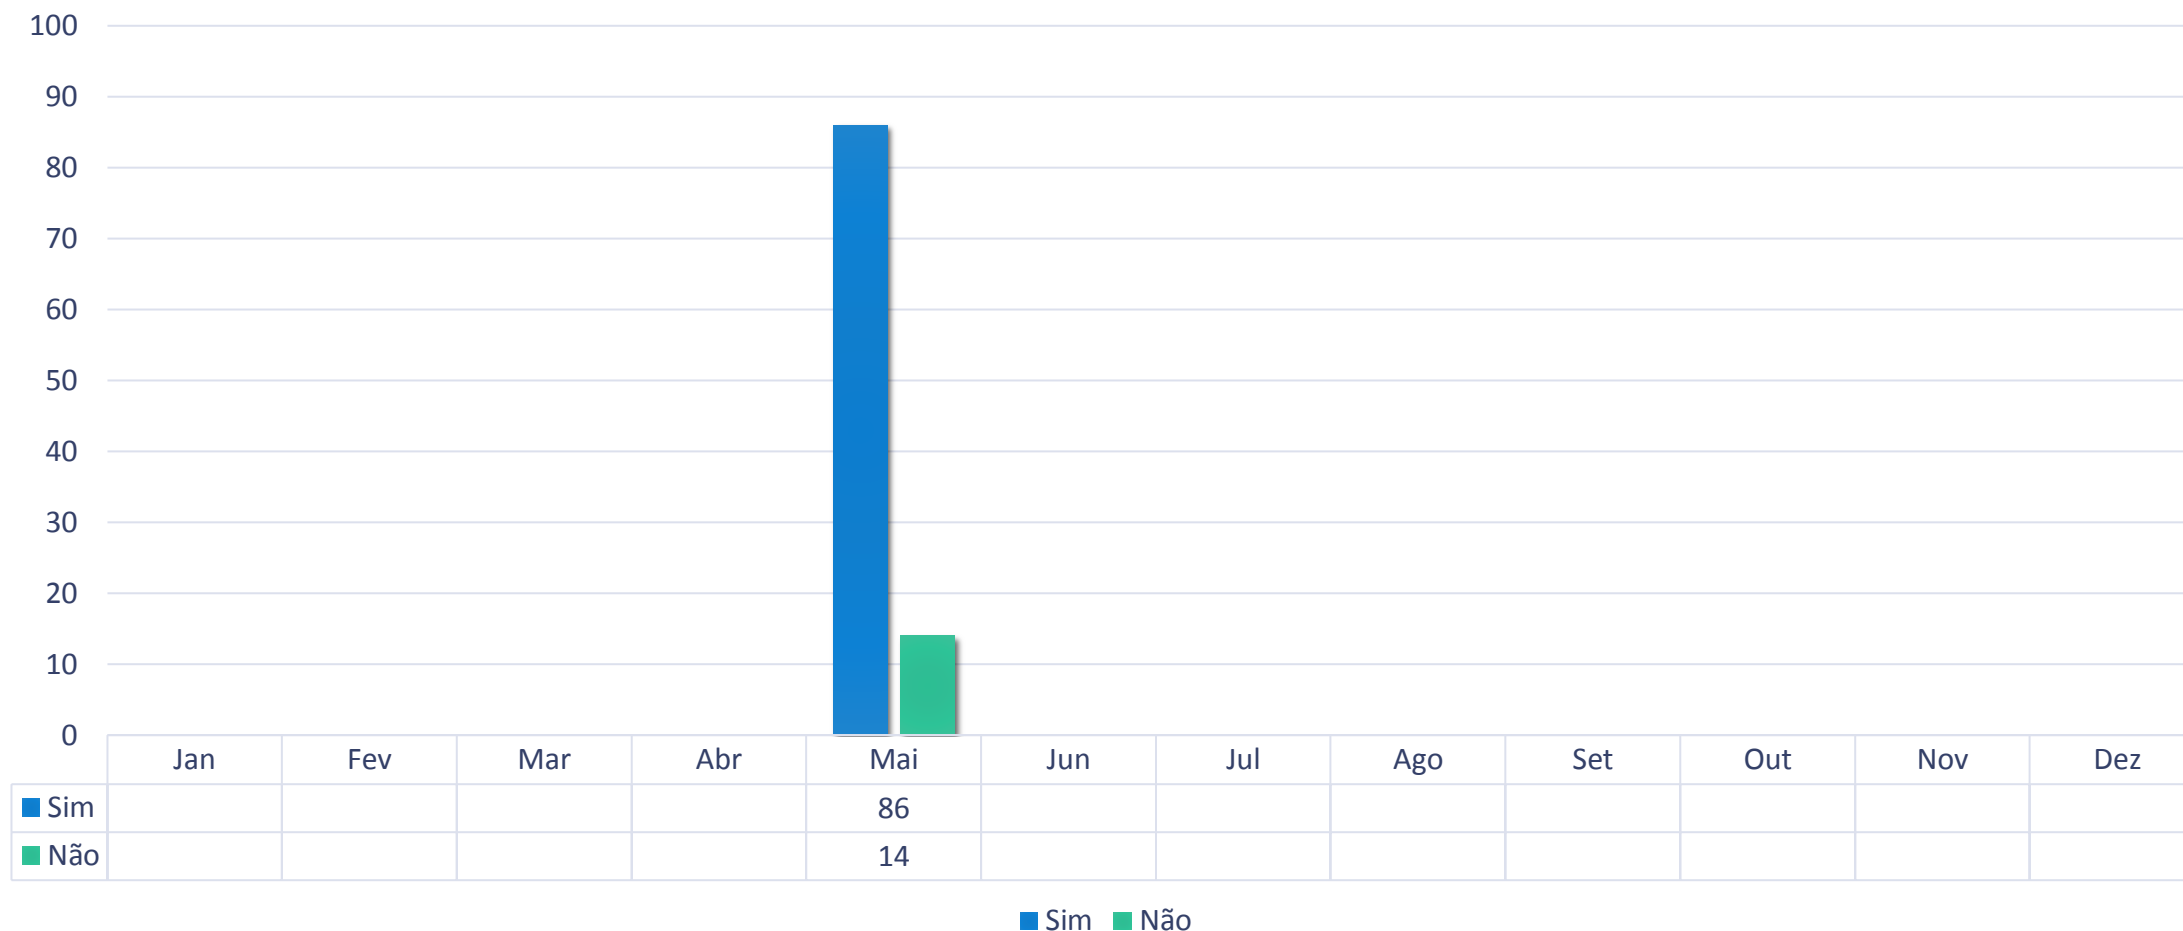

Mai/2021: As janelas do laboratório de simulação não podem ser abertas.


**Formulários
respondidos: 7
Discentes: 6
Docentes: 1**

Percentual de adequação do espaço físico no laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

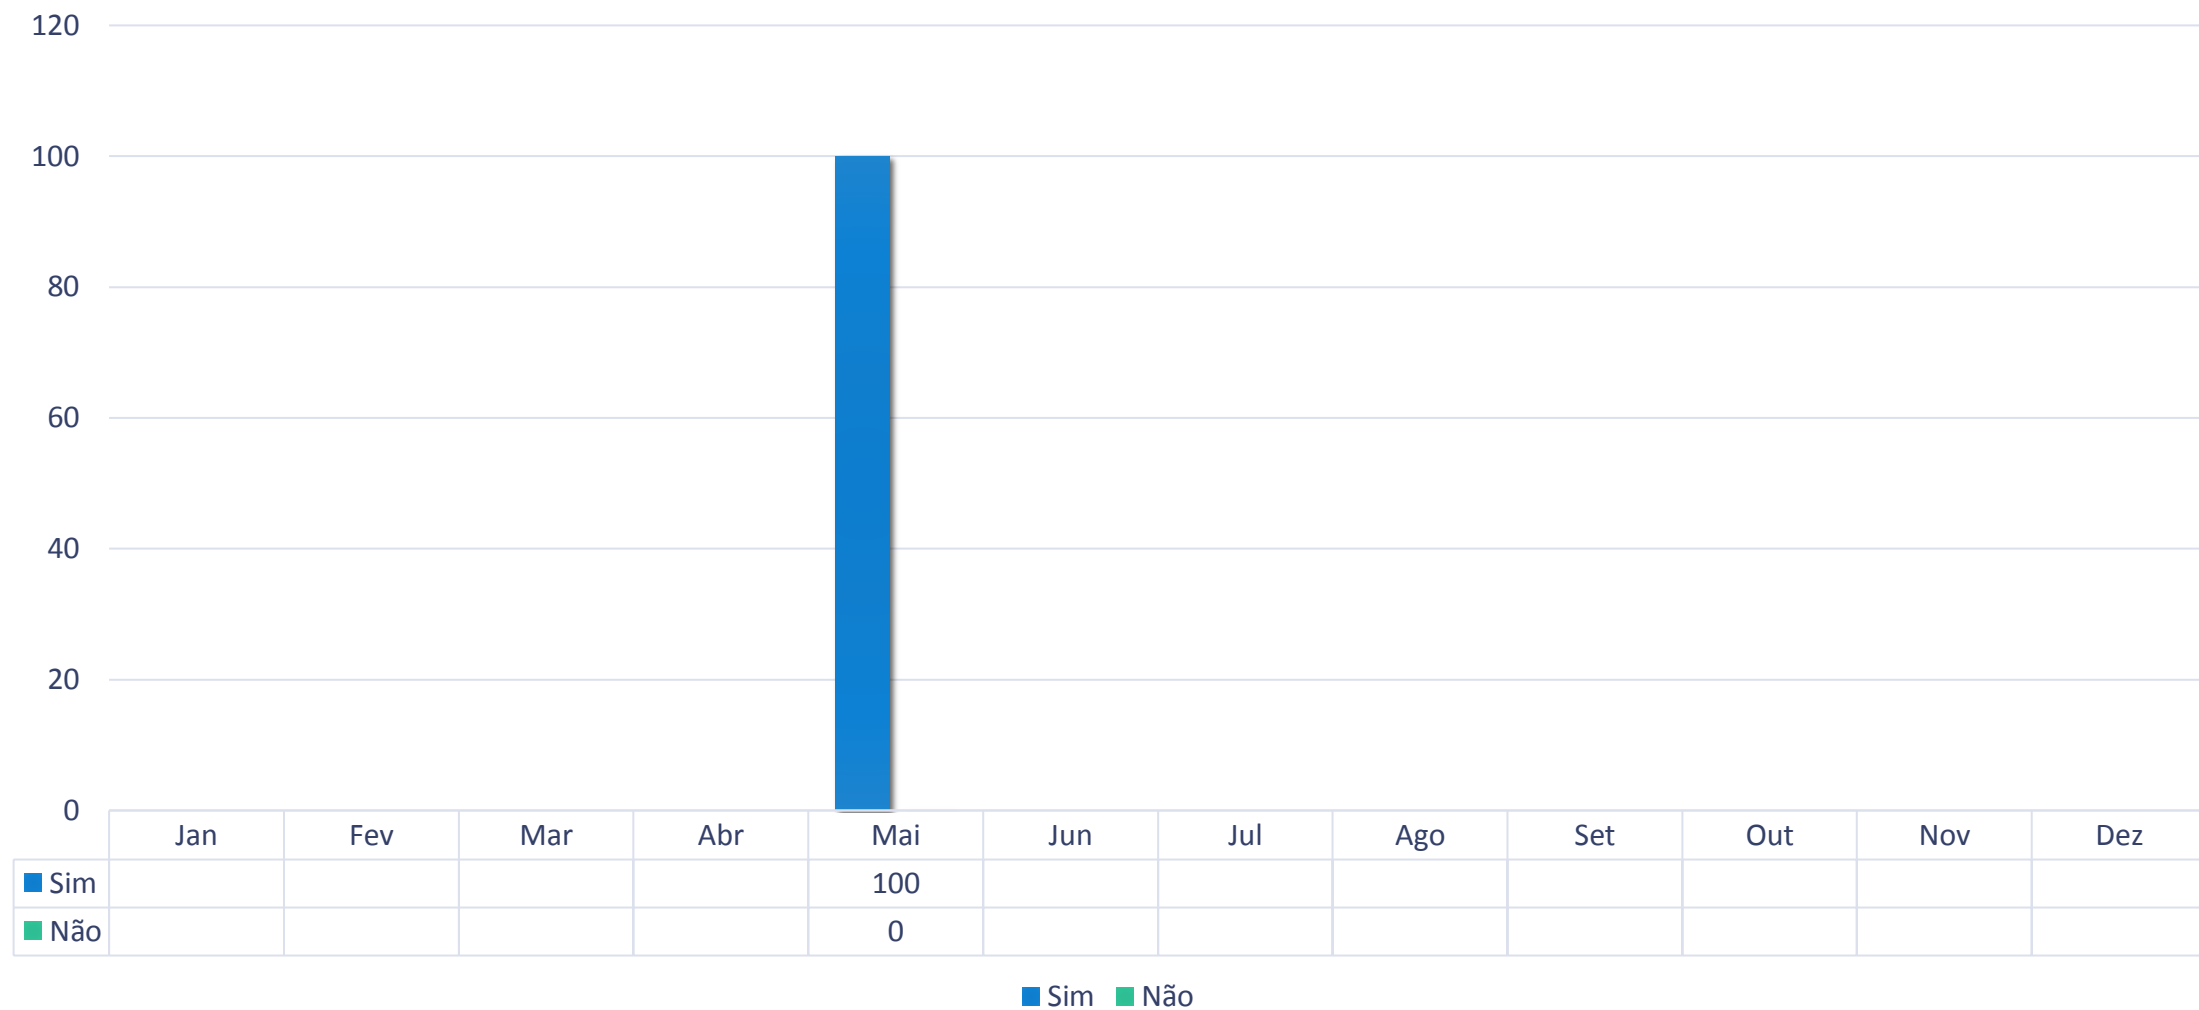


**Formulários
respondidos: 7
Discentes: 6
Docentes: 1**

Percentual de adequação da disponibilidade de material no laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

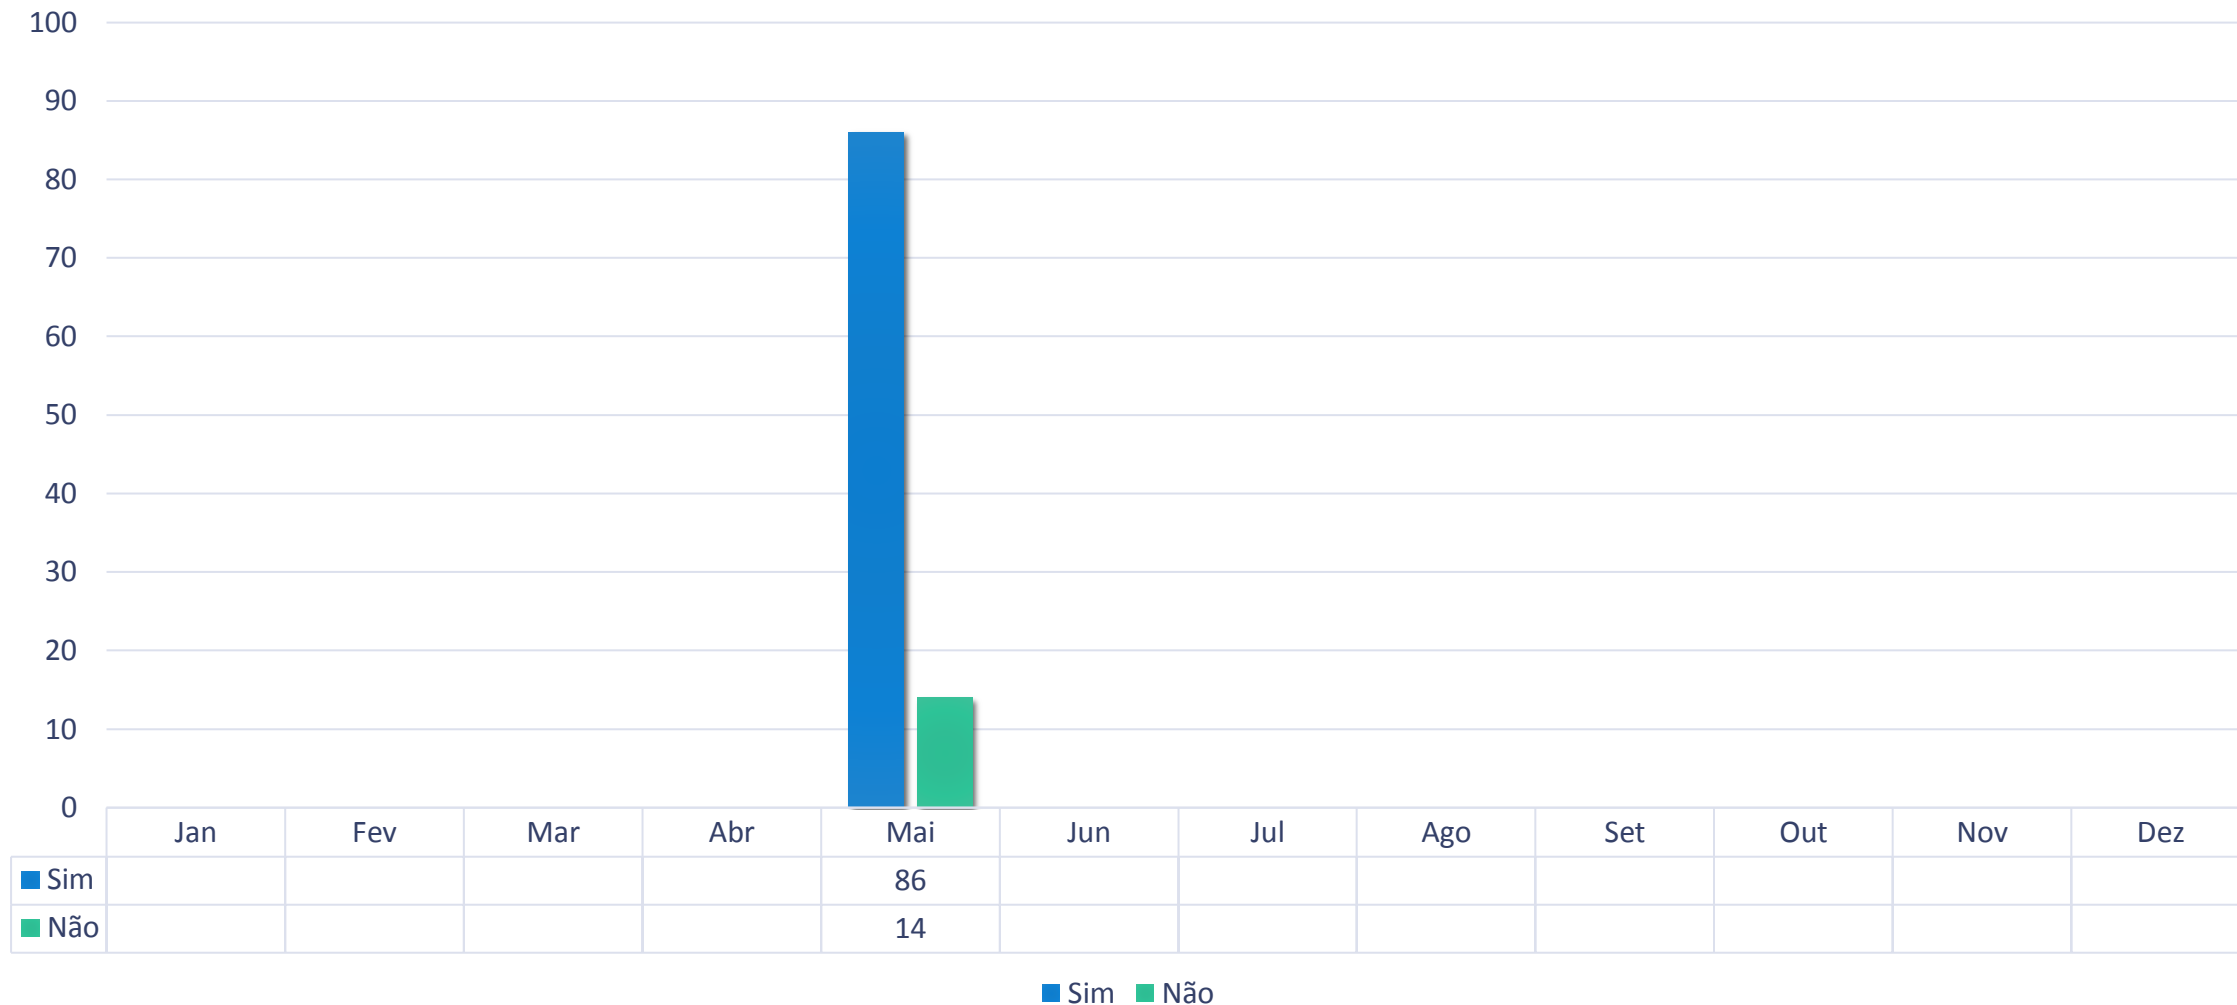


**Formulários
respondidos: 7
Discentes: 6
Docentes: 1**

Percentual de adequação da disponibilidade de equipamentos no laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

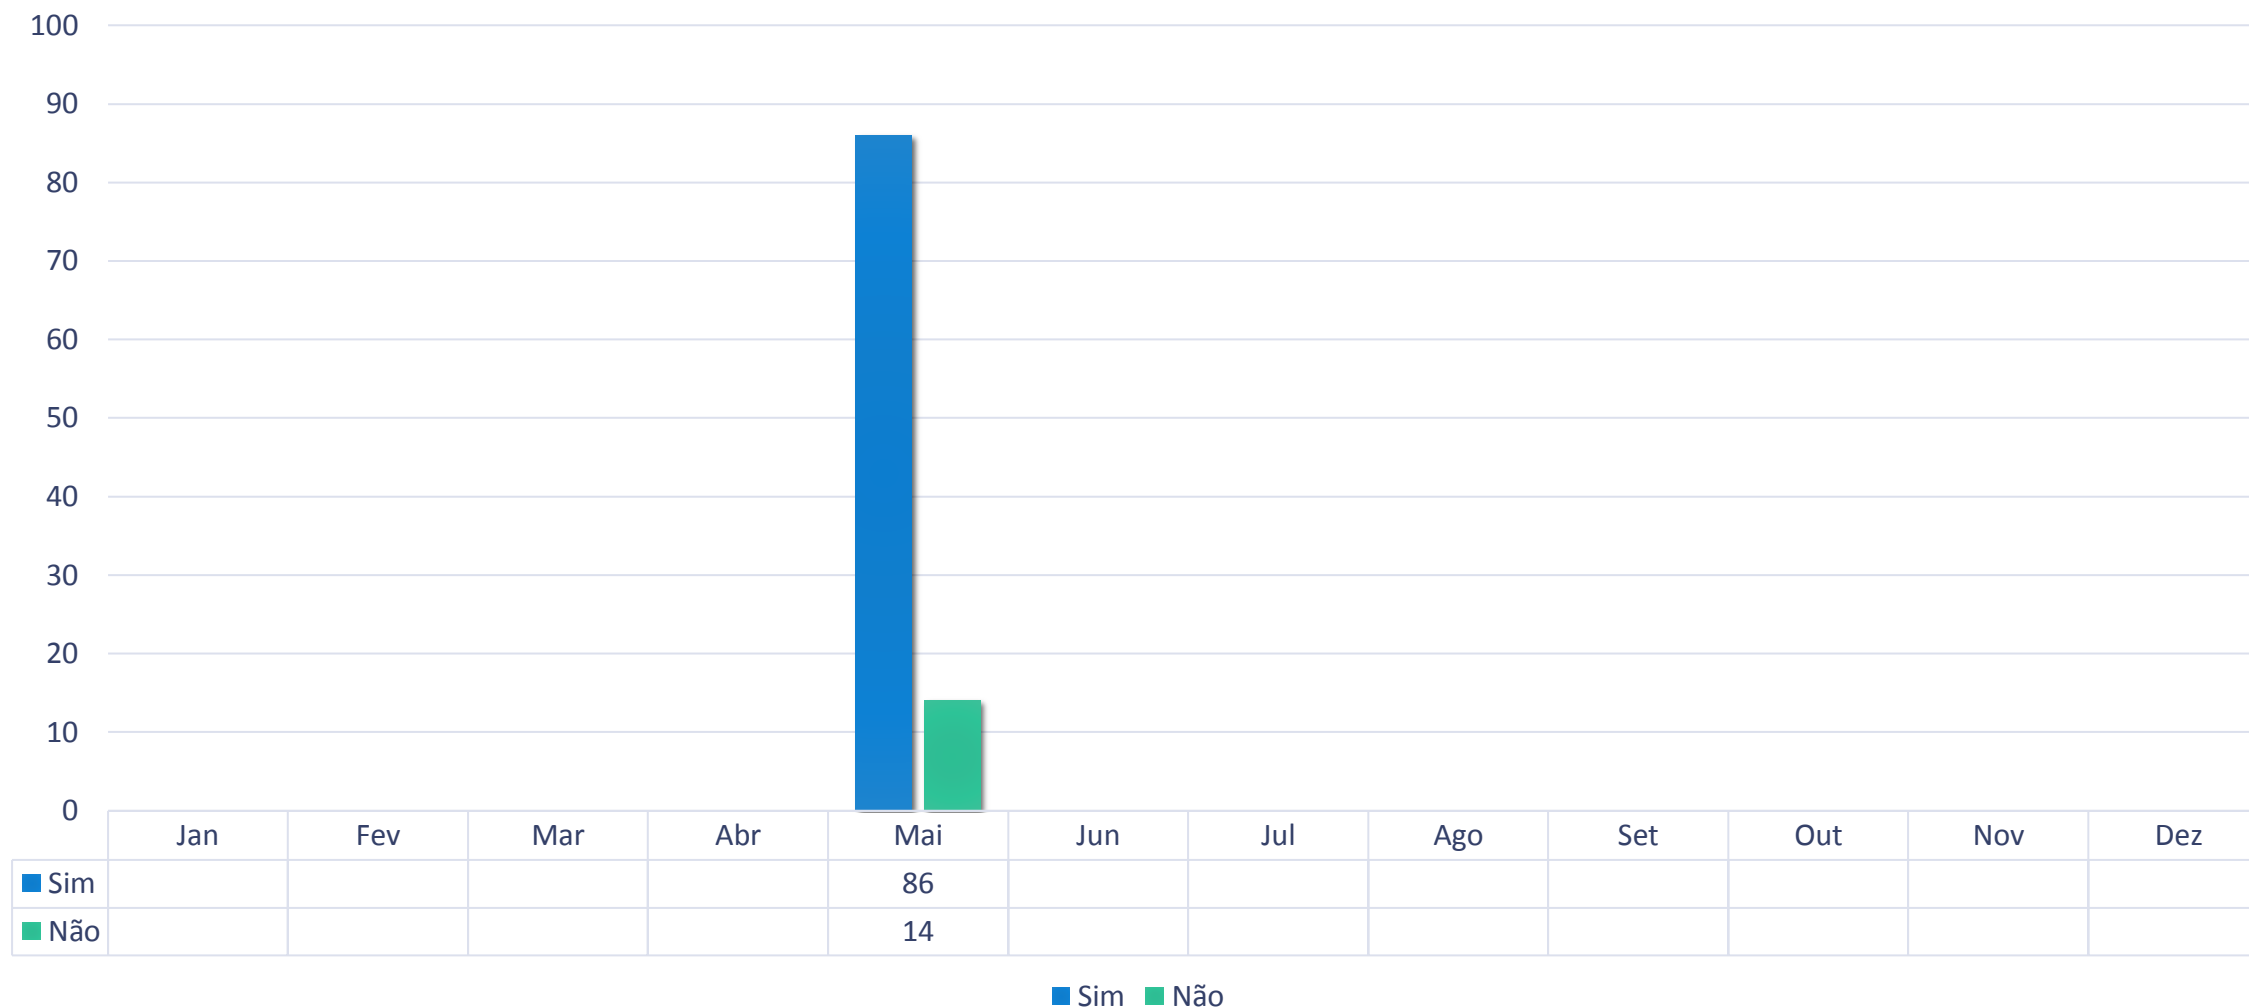


Percentual de adequação do funcionamento dos equipamentos no laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

Formulários respondidos: 7
Discentes: 6
Docentes: 1

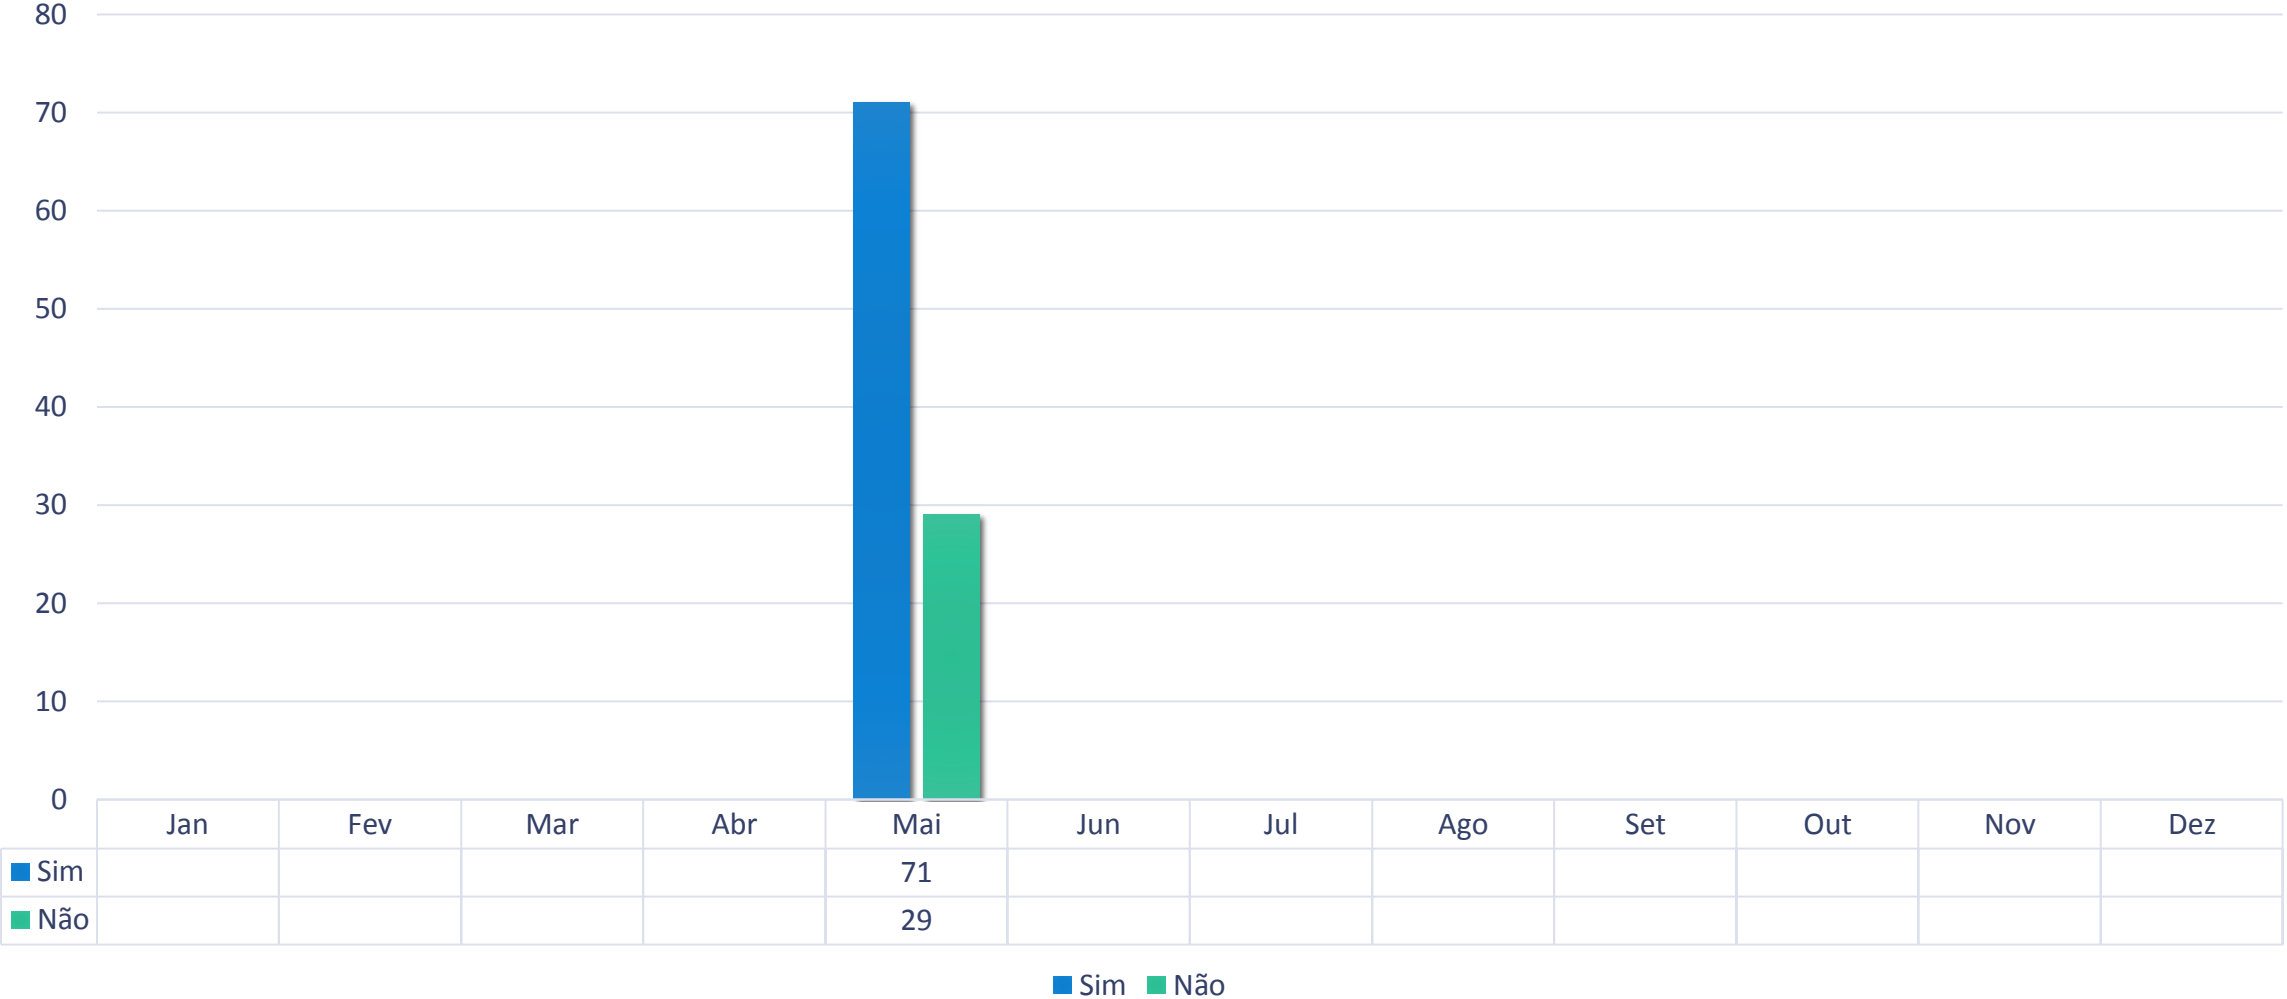


**Formulários
respondidos: 7
Discentes: 6
Docentes: 1**

Percentual de adequação da disponibilidade de manequins no laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

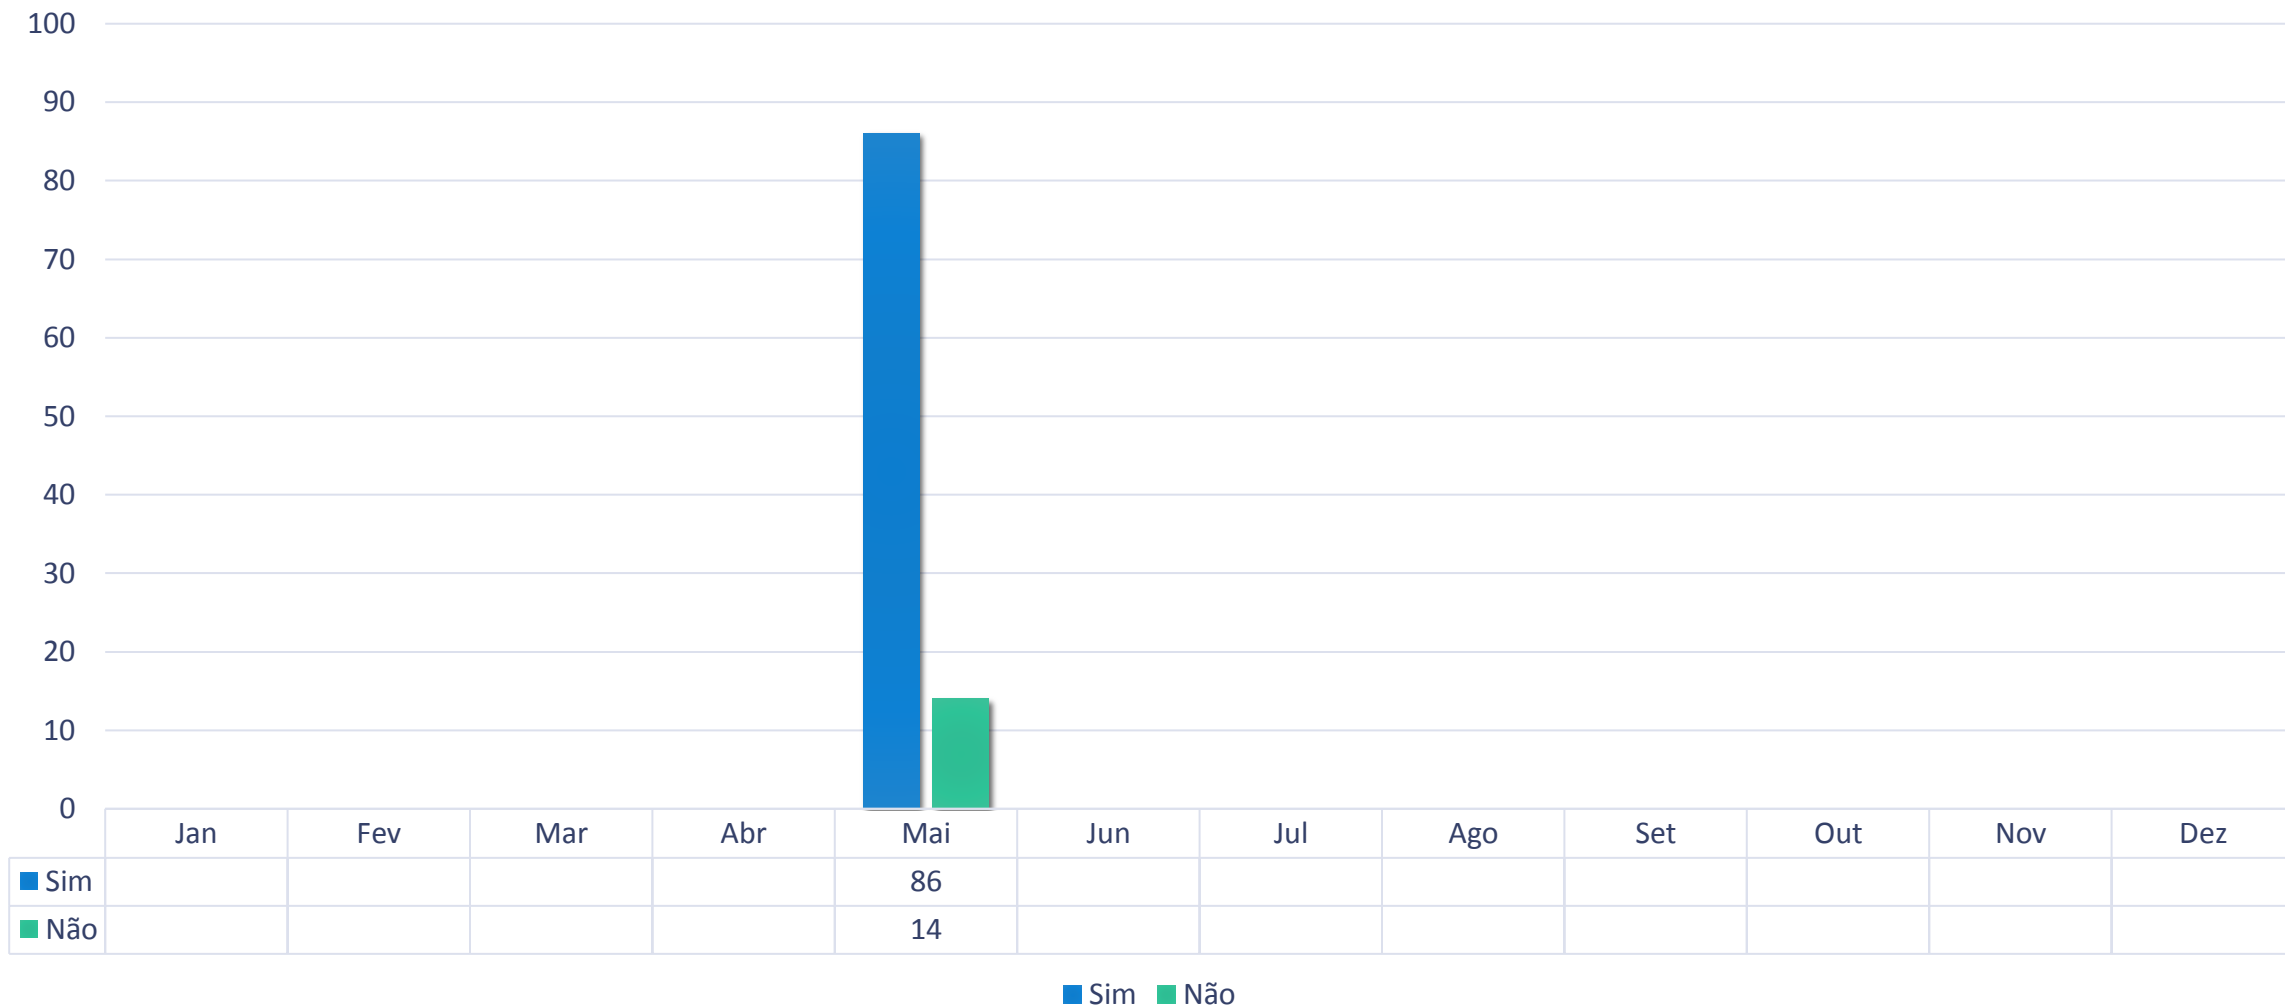


**Formulários
respondidos: 7
Discentes: 6
Docentes: 1**

Percentual de adequação do funcionamento de manequins no laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

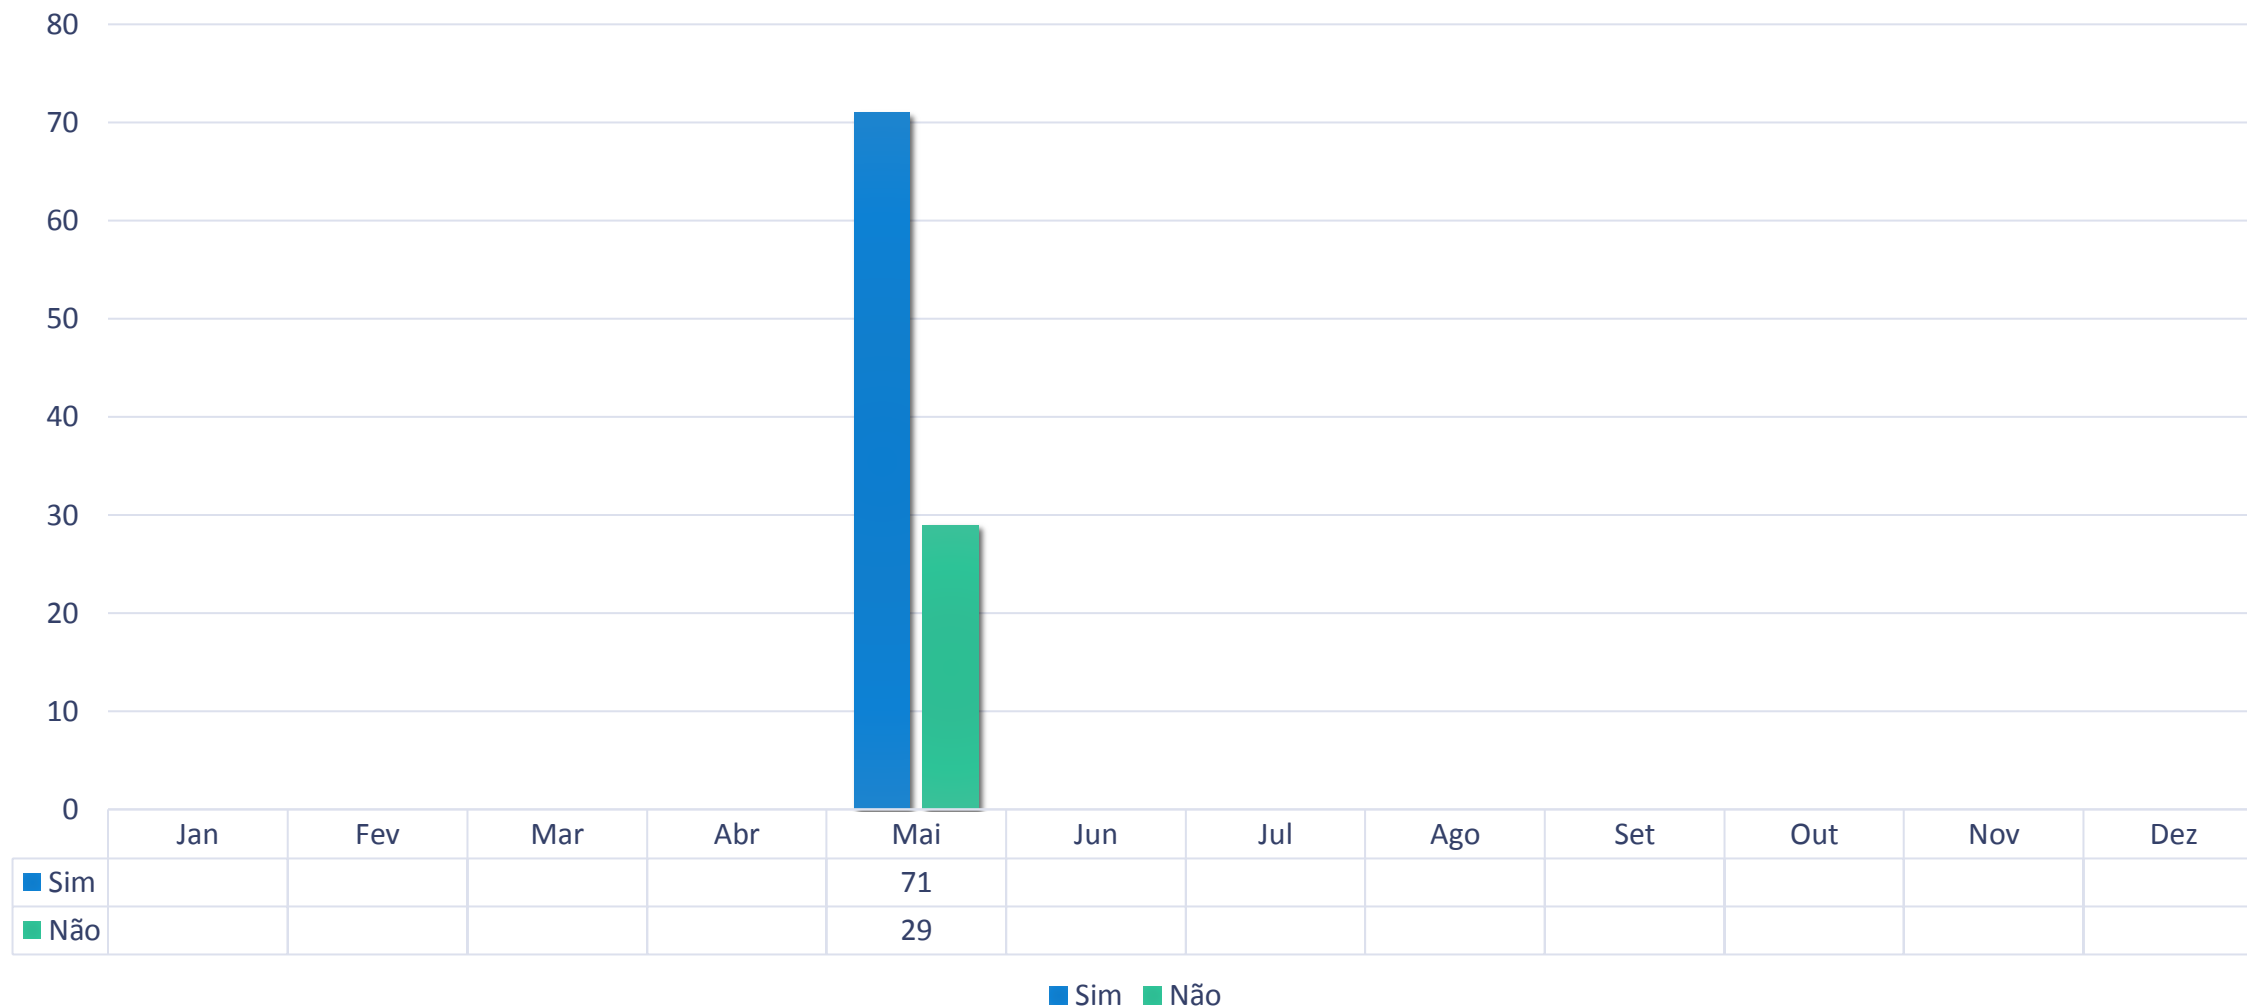

**Formulários
respondidos: 7
Discentes: 6
Docentes: 1**

Percentual de reconhecimento da presença da coordenação no laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

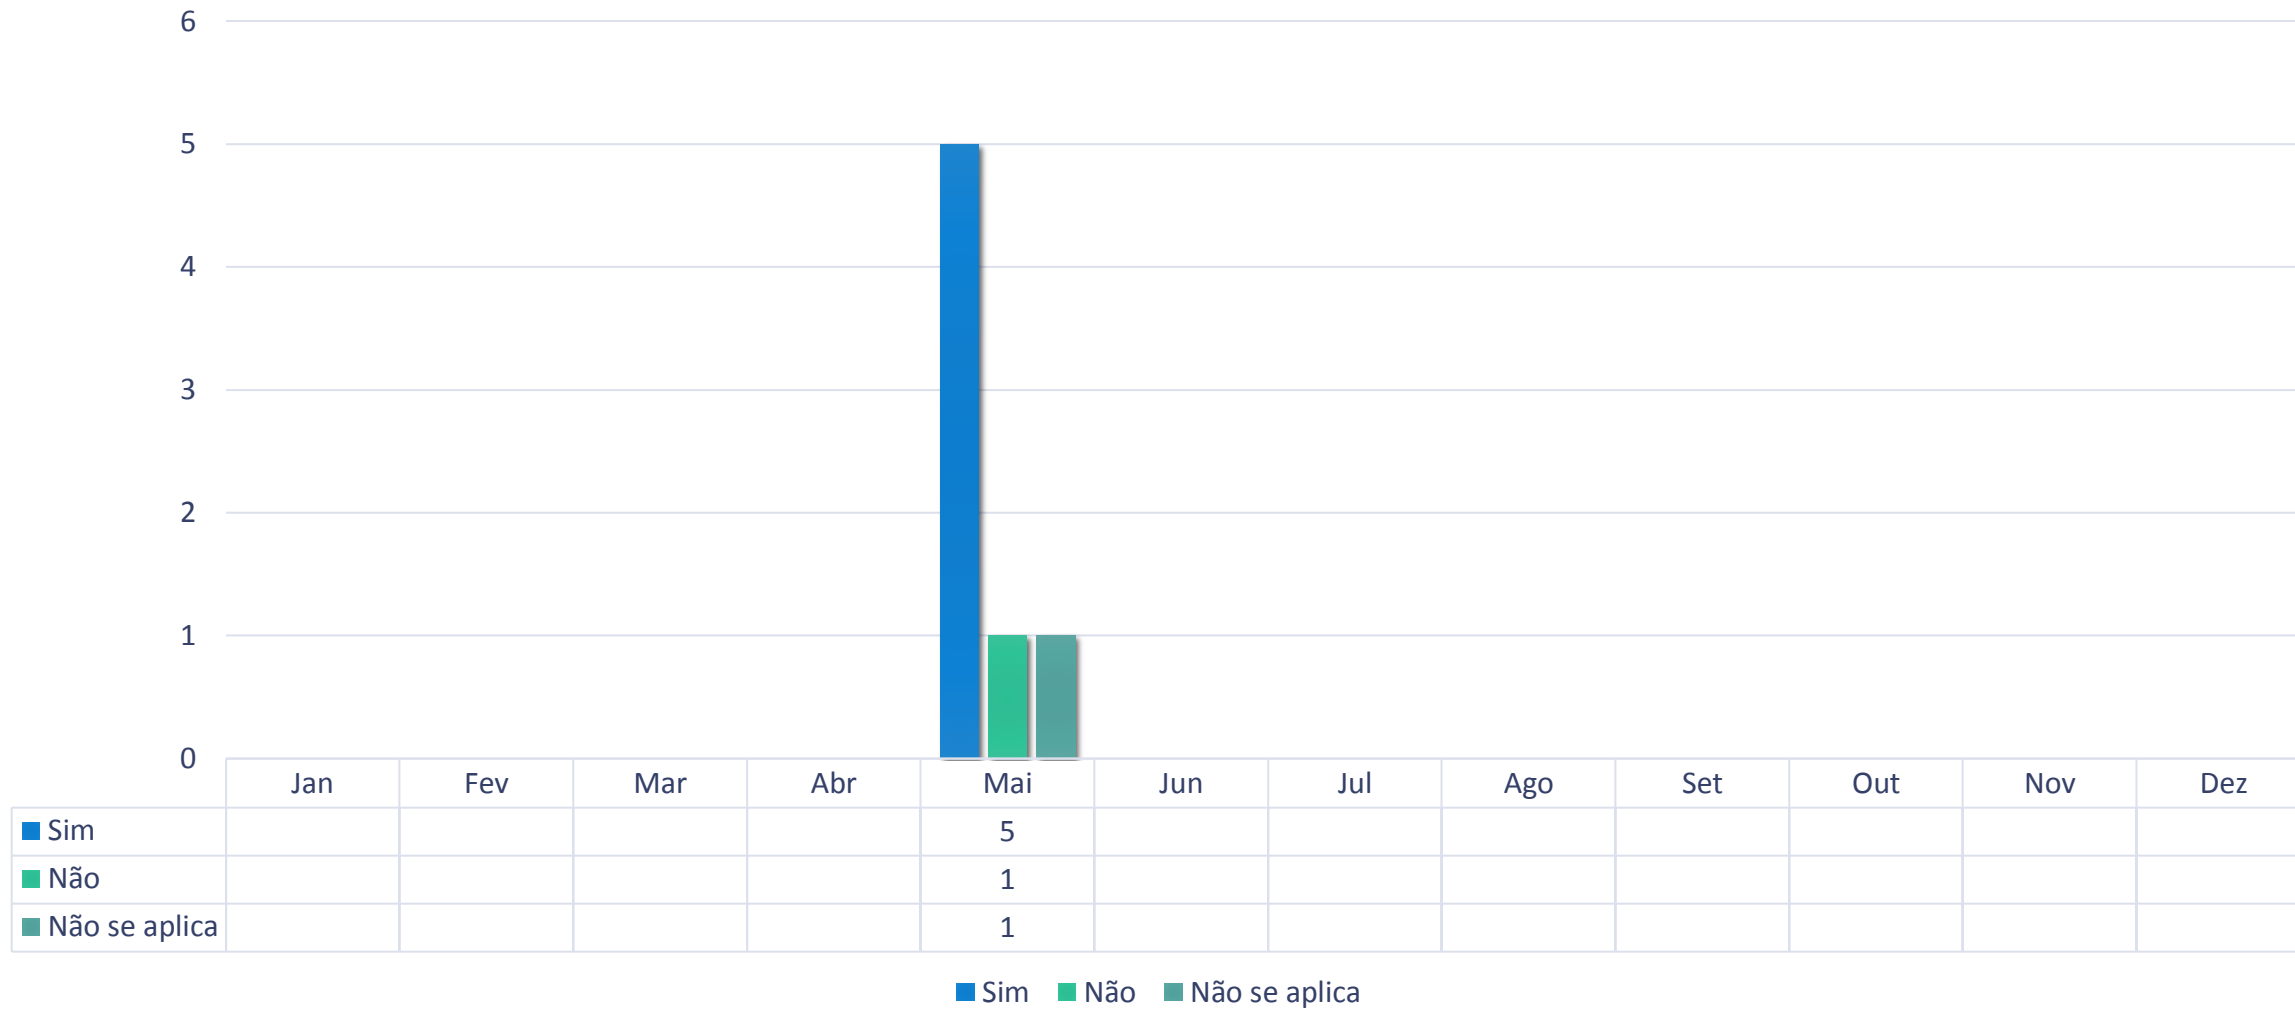


**Formulários
respondidos: 7
Discentes: 6
Docentes: 1**

Percentual de reconhecimento da presença do responsável técnico no laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO



**Formulários
respondidos: 7
Discentes: 6
Docentes: 1**


Percentual de reconhecimento do monitor no laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

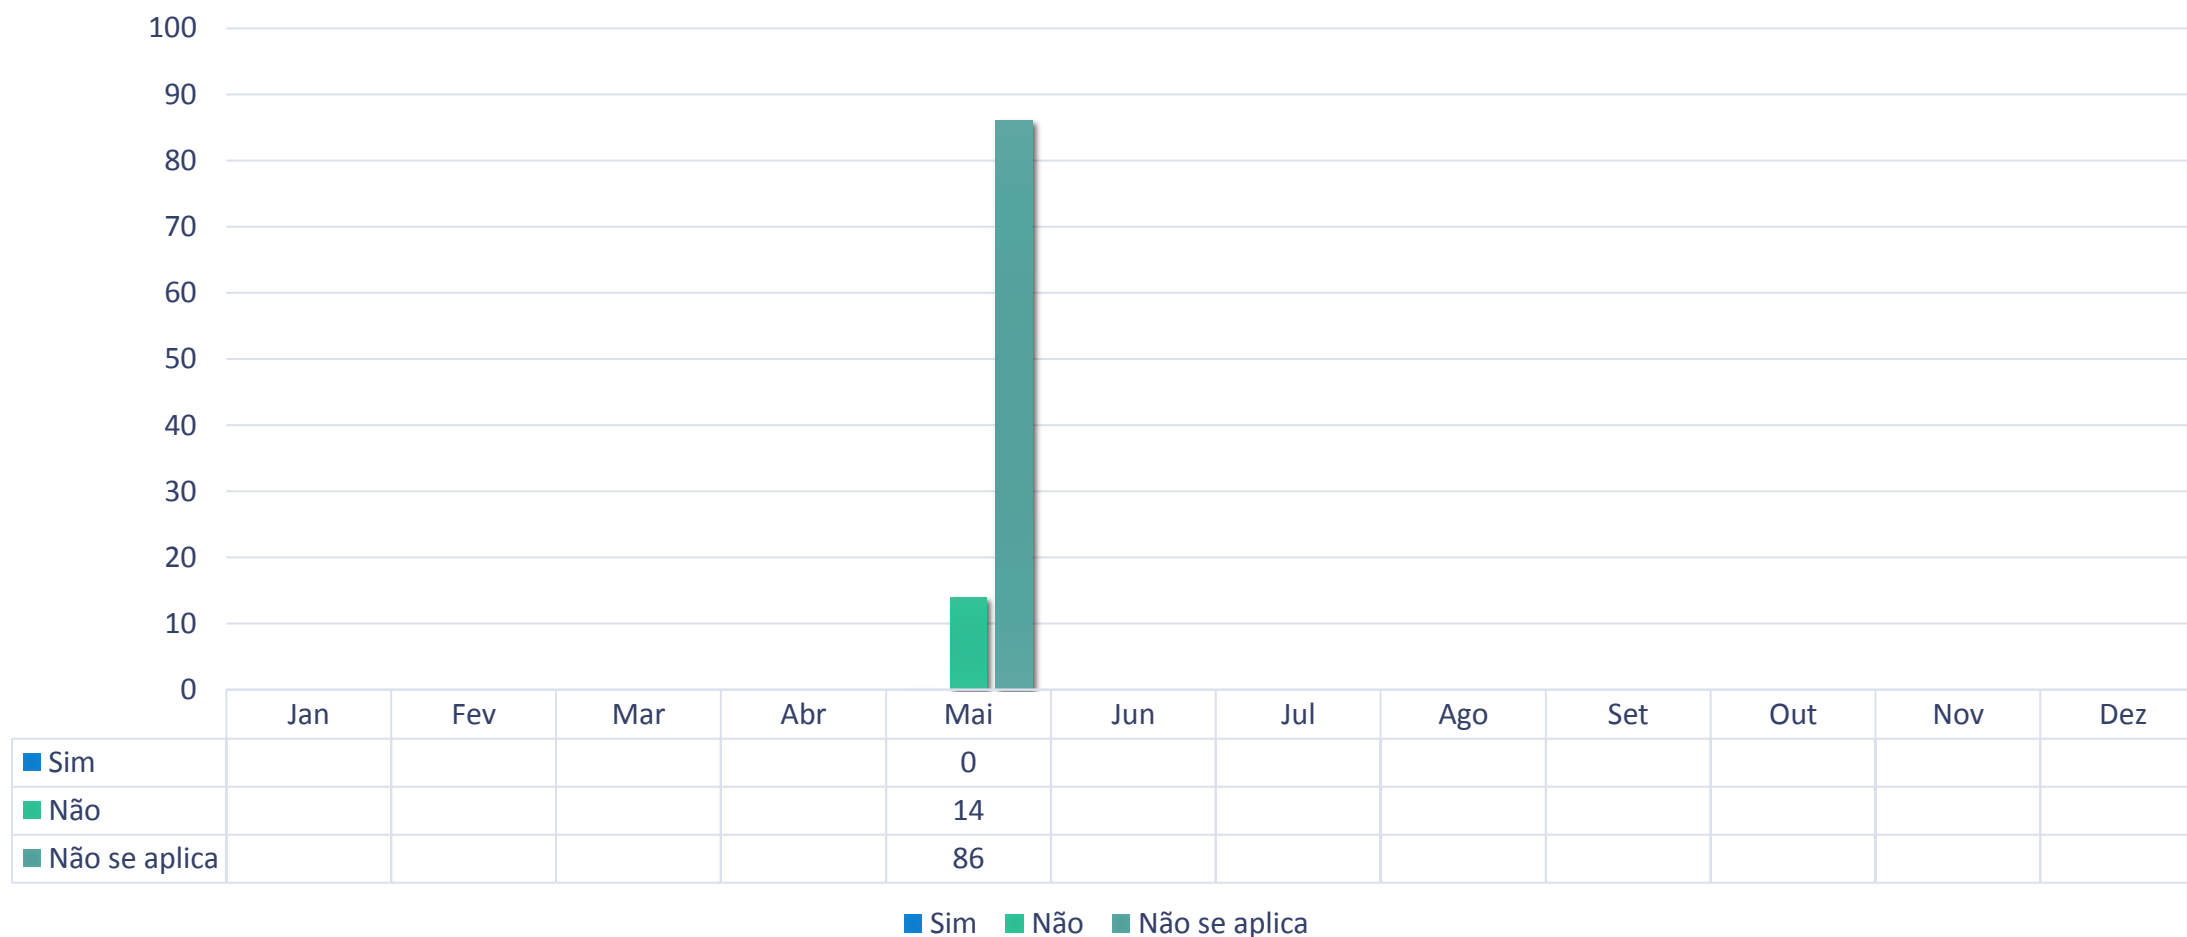

Mai/2021: Sem justificativa.

**Formulários
respondidos: 7
Discentes: 6
Docentes: 1**

Percentual de reconhecimento do professor no laboratório de simulação e aperfeiçoamento clínico - EEAP / UNIRIO

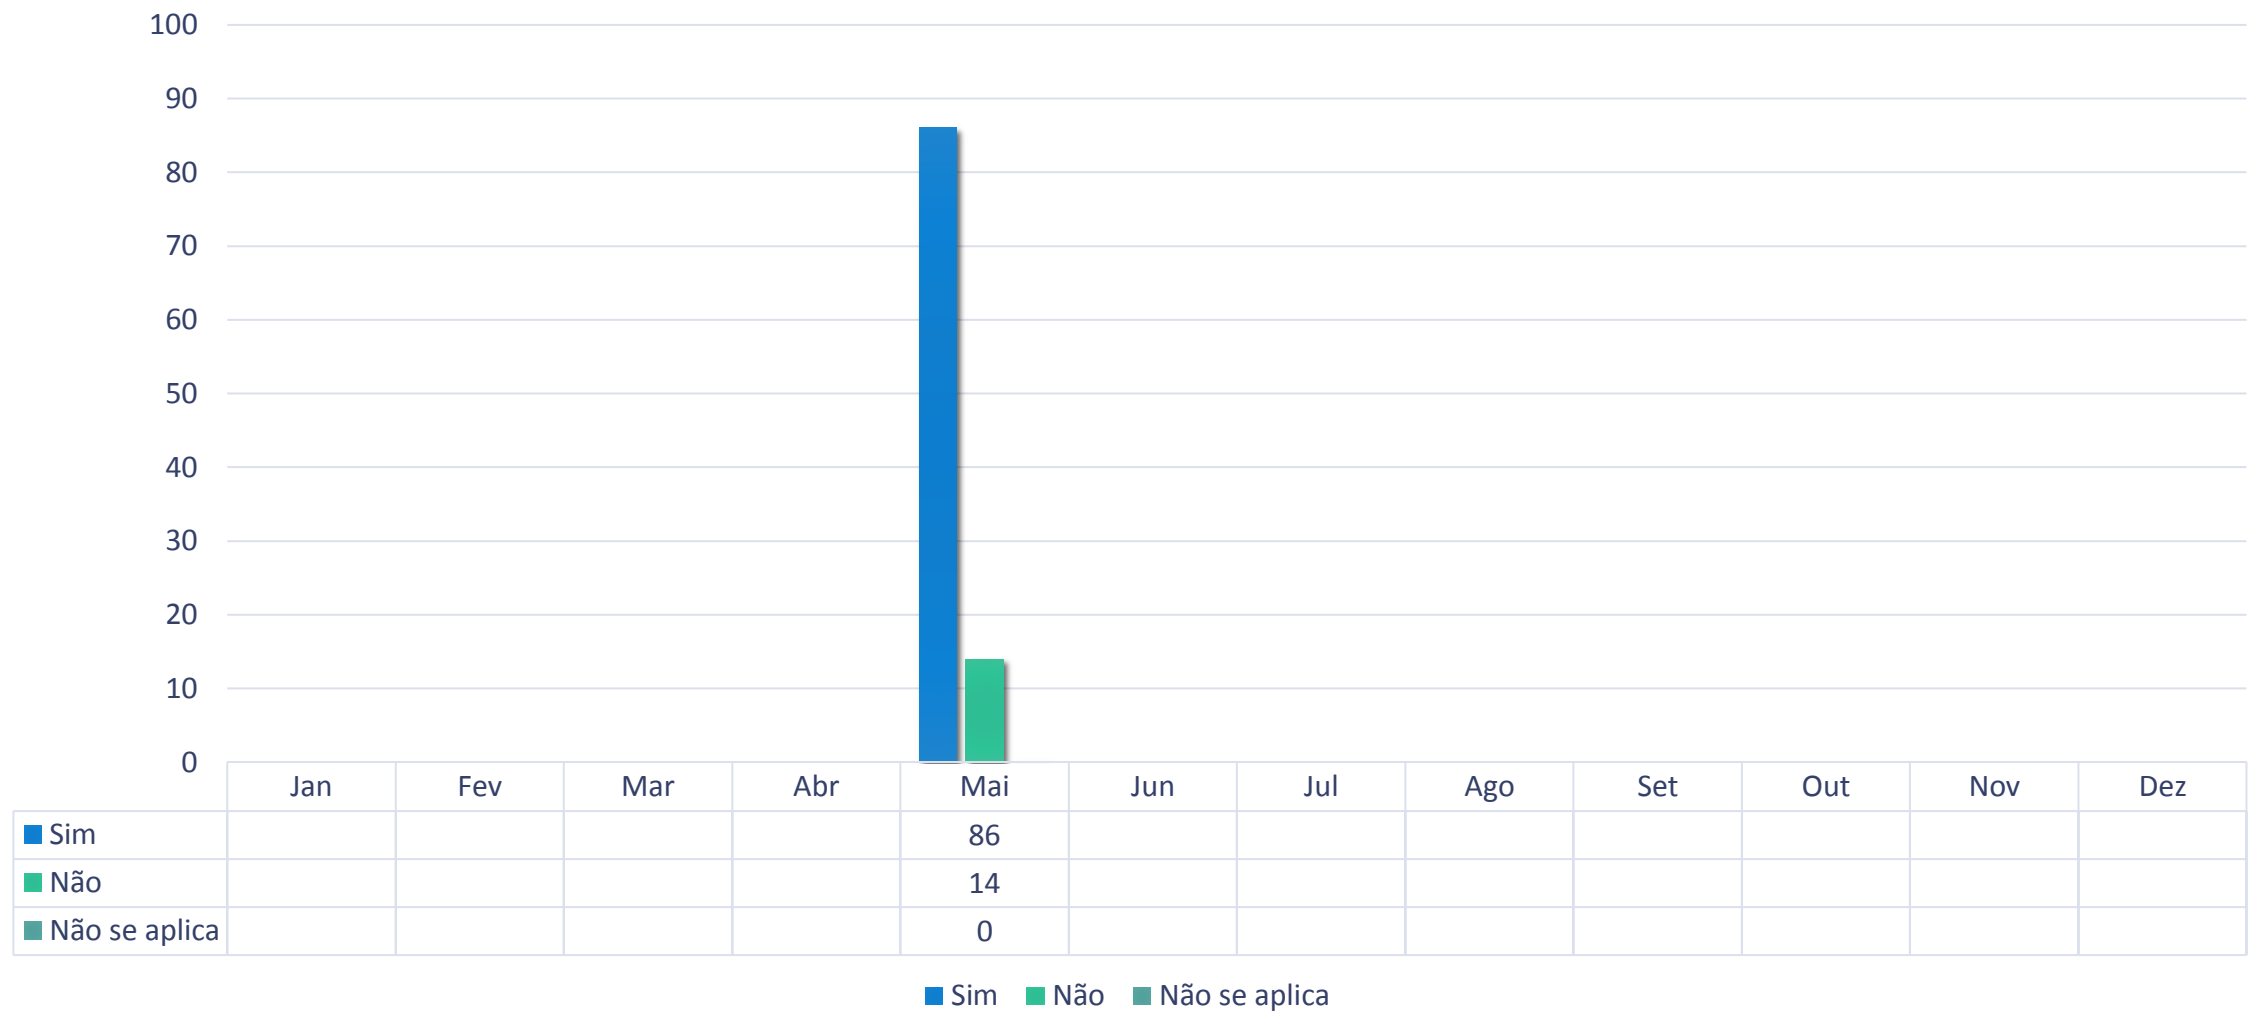

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO CLÍNICO

Data	Equipamento	Descrição do achado	Marca e especificação técnica	Necessidade de manutenção	Prazo de manutenção estipulado pelo fabricante	Última manutenção	Previsão de manutenção	Realizada
mai/21	Simulador Metiman	Problema apresentado: Conector do esfigmomanômetro. O compressor responsável pelo piscar dos olhos, expansão torácica e pulsos não estão funcionando. (Os olhos não possuem foto reatividade.)	Metiman de alta fidelidade e software MUSE EMPRESA CIVIAM	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SIMULADOR Desmontagem completa do simulador e verificação de seu funcionamento e Substituição de peças listadas abaixo: Compressor completo cód. 253K355102; par de olhos reativos cód. 147K353700; Adaptador para Esfigmomanômetro cód.415K350000	Envio de termo de referência 13/05/2021			Em andamento



UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CCBS
ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO - EEAP
LABORATÓRIO DE HABILIDADE NOS CUIDADOS EM SAÚDE – LHACUS



ALERTAS

- Não usar caneta;
- Não usar fita adesiva;
- Lavar com água e sabão após o uso;
- Não usar álcool.



UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – CCBS
ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO – EEAP
LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO CLÍNICO



APRESENTAÇÃO MANEQUINS

Rachel de Oliveira Gomes da Silva

Enfermeira Responsável Técnica do Laboratório de Habilidades nos Cuidados em Saúde e Laboratório de Simulação e Aperfeiçoamento Clínico

FEVEREIRO - 2021